



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
UNIVERSITY OF NIŠ

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ
FACULTY OF OCCUPATIONAL SAFETY



РЕПУБЛИКА СРБИЈА, 18000 Ниш, Чарнојевића 10 А, Тел: (018)529-701, Факс: (018)249-962, Т.Р.840-1747666-77, ПИБ 100663853, М.Б.07226063
E-mail: info@znrfak.ni.ac.rs, www.znrfak.ni.ac.rs

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

broj izveštaja: 01/03-22/21


Datum: 05. 10. 2018.	Izdanje: 1	Kopija: ORIGINAL	Izmena: -	Ukupno strana: 22
-------------------------	---------------	---------------------	--------------	----------------------

Kontrolisana kopija.

Zabranjeno kopiranje i preštampavanje, osim u celosti, bez saglasnosti Centra za tehnička ispitivanja.



Univerzitet u Nišu
Fakultet zaštite na radu u Nišu
CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



PODACI O KORISNIKU


Naziv korisnika:	Grad Niš - Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine
Adresa korisnika:	Niš, Ul. Nikole Pašića 24
Rešenje o registraciji kod nadležnog trgovinskog suda ili agencije za privredne registre:	-
Pretežna delatnost:	-
PIB / MB:	100232752 / 17620541
Odgovorno lice:	Ivana Krstić, dipl. inž., sekretar sekretarijata
Kontakt podaci:	Dragana Džombić, tel. 018-504-569 e-mail: dragana.dzombic@gu.ni.rs

PODACI O ISPITIVANJU

Zahtev za ispitivanje:	Q.CTI.OB.014/07-07-17-006
Zapisnik o preispitivanju zahteva za ispitivanje:	Q.CTI.OB.016/10-07-17-007
Ponuda za ispitivanje:	Q.CTI.OB.017/11-07-17-008
Ugovor:	01/03-16/1 od 28. 08. 2017. godine
Radni nalog za ispitivanje:	-
Predmet ispitivanja:	Kontinuirani dugotrajni monitoring stanja nivoa buke od septembra 2017. g. do avgusta 2018. g. na lokacijama: 1. Bulevar dr Zorana Đinđića – Klinički centar - Klinika za kardiovaskularne bolesti 2. Bulevar Dimitrija Tucovića – Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“ – Centar Niš
Standard/propis/validovana metoda	Merenje nivoa buke u životnoj sredini SRPS ISO 1996-1:2010 SRPS ISO 1996-2:2010 Šifra metode: 1996-LVB-01 Akreditovana metoda: DA ☒ NE ☐
Mesto i datum ispitivanja:	Niš, 2017/2018
Zapisnik o ispitivanju:	-
Ispitivači:	Automatizovano merenje



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije




SADRŽAJ

1. OPŠTI DEO	4
1.1 Spisak korišćenih dokumenata.....	4
1.1.1 Spisak korišćenih dokumenata u proceduri ispitivanja	4
1.2.2 Spisak korišćenih dokumenata u izradi izveštaja	4
1.2 Korišćena merna oprema u proceduri akustičkih ispitivanja.....	4
2. PODACI O MERNIM MESTIMA	6
3. INDIKATORI BUKE.....	8
3.1 Mesečni indikatori buke.....	8
5.2 Nedeljni indikatori buke	10
3.3 Indikatori buke za petodnevni period radnih dana.....	14
3.4 Indikatori buke za vikende	18



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



1. OPŠTI DEO

1.1 SPISAK KORIŠĆENIH DOKUMENATA

1.1.1 Spisak korišćenih dokumenata u proceduri ispitivanja

- SRPS ISO 1996-1:2010 - Akustika - Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini - Deo 1: Osnovne veličine i procedure ocenjivanja;
- SRPS ISO 1996-2:2010 - Akustika - Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini - Deo 2: Određivanje nivoa buke u životnoj sredini.
- Q.CTI.PR.03 Procedura za sprovođenje laboratorijskog ispitivanja
- Q.CTI.UP.10 Uputstvo za merenje buke u životnoj sredini

1.2.2 Spisak korišćenih dokumenata u izradi izveštaja


- Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, ("Službeni glasnik R. Srbije" br. 75/2010);
- Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke, ("Službeni glasnik R. Srbije" br. 72/2010);
- Q.CTI.UP.04 Uputstvo za izradu izveštaja o ispitivanju

1.2 KORIŠĆENA MERNA OPREMA U PROCEDURI AKUSTIČKIH ISPITIVANJA

	Komponenta		Serijski br.	Inv. broj
Merna stanica 1 (tip 3636-B-203) oznaka: NMT-1	1.1	Kabinet stanice, tip 3636-B-100	2870021	3158
	1.2	Merač nivoa zvuka Bruel&Kjaer, tip 2250-N	3001588	
	1.3	Mikrofon Bruel&Kjaer, tip 4189	2850910	
	1.4	Pribor za mikrofon Bruel&Kjaer, tip UA-1404	-	
	1.5	Predpojačavač Bruel&Kjaer, tip ZC-0032	18212	
	1.6	Akumulatorska baterija, tip QB-0065	195579-006	
	1.7	Pribor za montažu za stub/zid, tip UA-2198	-	
	1.8	GPRS ruter sa antenom	-	
	1.9	GPS prijemnik ZZ-0249 „Garmin“ model 16x-HVS	191957/0	
	1.10	Merni softver Bruel&Kjaer BZ-7232, verzija 4.15 Licenca br. 65B8 7D2E CEB9 4F6A	3001588	
	1.11	Merni softver Bruel&Kjaer BZ-7223, verzija 4.x Licenca br. 4DA8 C290 A792 371B	3001588	
	1.12	Merni softver Bruel&Kjaer BZ-7222, verzija 4.x Licenca br. 5193 66D2 9E5F DBA5	3001588	
Datum poslednje kalibracije: 18-08-2017				



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije




ATC
01-393
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2006

	Komponenta		Serijski br.	Inv. broj
Merna stanica 2 (tip 3636-B-203) oznaka: NMT-2	2.1	Kabinet stanice, tip 3636-B-100	2870020	3159
	2.2	Merač nivoa zvuka Bruel&Kjaer, tip 2250-N	3001596	
	2.3	Mikrofon Bruel&Kjaer, tip 4189	2850909	
	2.4	Pribor za mikrofon Bruel&Kjaer, tip UA-1404	-	
	2.5	Predpojačavač Bruel&Kjaer, tip ZC-0032	18199	
	2.6	Akumulatorska baterija, tip QB-0065	195579-005	
	2.7	Pribor za montažu za stub/zid, tip UA-2198	-	
	2.8	GPRS ruter sa antenom	-	
	2.9	GPS prijemnik ZZ-0249 „Garmin“ model 16x-HVS	197467/0	
	2.10	Merni softver Bruel&Kjaer BZ-7232, verzija 4.15 Licenca br. 747D D22A ABE5 E5DB	3001596	
	Datum poslednje kalibracije: 18-08-2017			
Računar sa ENMS softverom	3.1	PC računar Bruel&Kjaer, tip3642: Proizvođač: DELL Model: Optiplex 7010 Procesor: Intel (R) Core (TM) i7-3770CTU@3.4GHz RAM. 8 Gb Hard disk: 700 Gb Software: Windows 7 Office: Microsoft Office 2013	2905168	3160
	3.2	Monitor za računar: Dell model P2012Ht	CN-02HPRT-74445-34K-HNDS	
	3.3	PC softver ENMS, tip 7843, verzija 2.8.1 (server i klijent), Licenca br. OR45530-8379816	-	
	3.4	PC softver Bruel&Kjaer BZ-5298	-	
Metoerološka stanica	4.1	Meteorološka stanica, tip: WXT520 AAA0AC30B0, proizvođač: Vaisala	J3540025	3184
	Datum poslednje kalibracije: 06-09-2013 (interna provera etaloniranim meračem)			







CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA Laboratorija za buku i vibracije



2. PODACI O MERNIM MESTIMA


Oznaka mernog mesta: NMT-1

Lokacija: Bulevar dr Zorana Đinđića – Klinički centar - Klinika za kardiovaskularne bolesti
Tip saobraćajnice: Dvoscimna saobraćajnica sa četiri saobraćajne trake
GPS koordinate: Severna geografska širina: 43.3167657923998° (43°19'00")
Istočna geografska dužina: 21.9125790970177° (21°54'45")
Nadmorska visina: 200 m
Visina mikrofona: 4 m

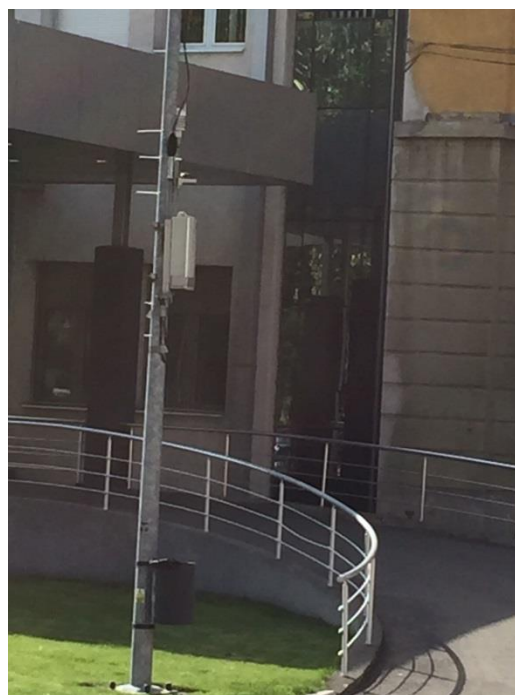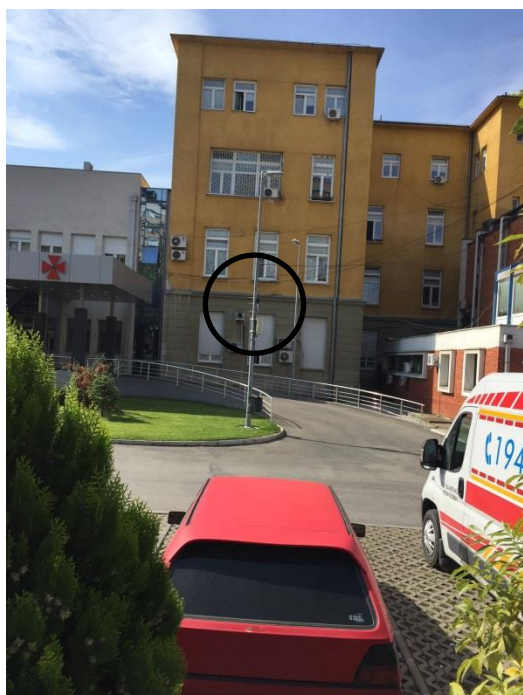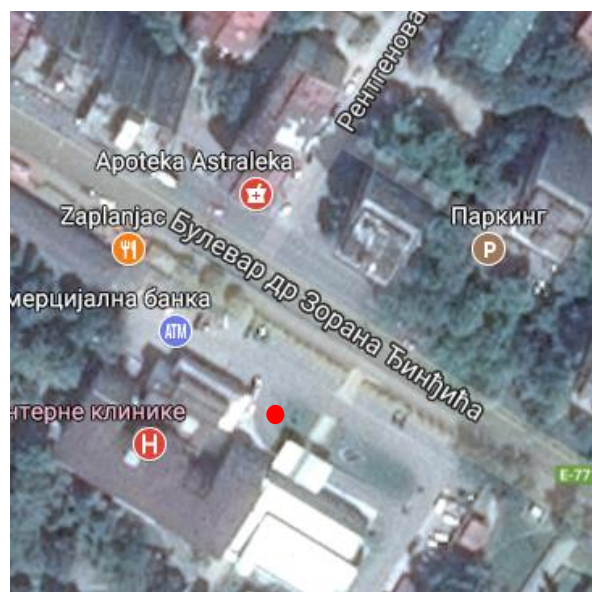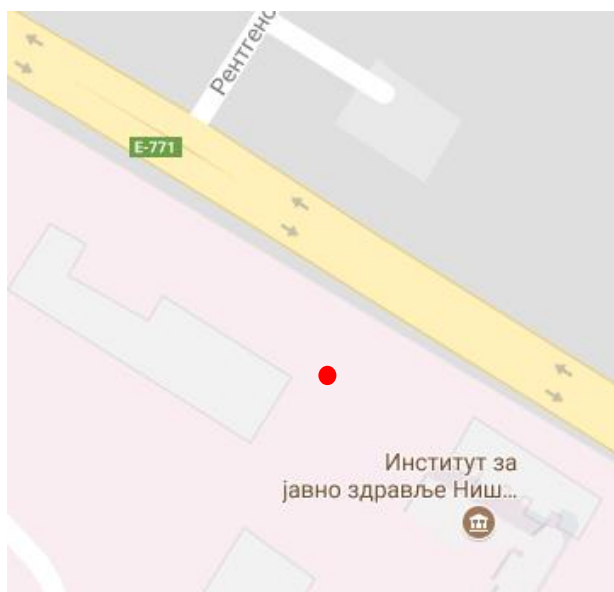



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA Laboratorija za buku i vibracije



Oznaka mernog mesta: NMT-2

Lokacija: Bulevar Dimitrija Tucovića – Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“ – Centar Niš

Tip saobraćajnice: Dvosmerna saobraćajnica sa četiri saobraćajne trake

GPS koordinate: Severna geografska širina: 43.3158271853179° (43°18'57")
Istočna geografska dužina: 21.8810280186523° (21°52'51.5")
Nadmorska visina: 192 m

Visina mikrofona: 4 m iznad nivoa saobraćajnice






3. INDIKATORI BUKE

3.1 MESEČNI INDIKATORI BUKE


NMT - 1					
	L_{day} [dB]	L_{evening} [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{\text{eq, total}}$ [dB]
Septembar 2017	63.3	63.0	58.8	66.6	62.1
Oktobar 2017	64.0	63.9	59.6	67.5	62.9
Novembar 2017	63.9	64.6	59.5	67.6	63.0
Decembar 2017	64.3	64.6	59.9	67.8	63.3
Janaur 2018	63.7	63.4	59.7	67.4	62.7
Februar 2018	63.5	63.5	59.5	67.2	62.5
Mart 2018	63.7	63.2	59.5	67.2	62.7
April 2018	63.0	65.7	59.3	67.6	62.8
Maj 2018	62.7	63.2	59.4	67.0	62.0
Jun 2018	63.5	65.0	60.4	68.1	63.0
Jul 2018	62.6	62.7	58.8	66.5	61.7
Avgust 2018	62.5	63.0	59.1	66.7	61.7
Godišnja vrednost indikatora	63.4	63.8	59.5	67.3	62.5
Standardna devijacija	0.56	0.90	0.43	0.48	0.51
Maksimalna vrednost	64.3	65.7	60.4	68.1	63.3
Minimalna vrednost	62.5	62.7	58.8	66.5	61.7
Granične vrednosti indikatora (zona 1 – bolnička zona)	50	50	40	-	-
Prekoračenje srednje vrednosti	13.4	13.8	19.5	-	-

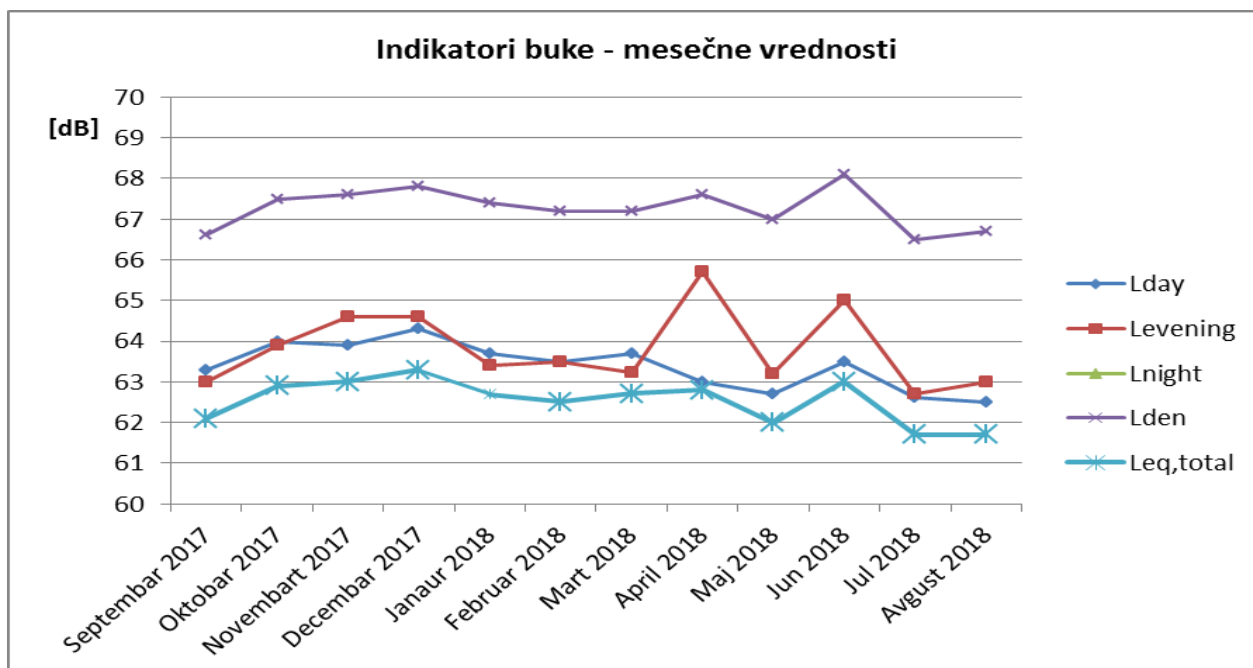

Sl. 1 Promene mesečnih vrednosti indikatora buke u toku 2017/2018 za NMT-1




CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



ATC
01-393
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2006


NMT - 2					
	L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
Septembar 2017	68.8	68.0	64.0	71.9	67.5
Oktoibar 2017	69.4	68.7	64.5	72.5	68.1
Novembar 2017	69.5	68.8	64.5	72.5	68.2
Decembar 2017	69.6	69.2	64.9	72.8	68.4
Janaur 2018	69.1	68.4	64.3	72.2	67.9
Februar 2018	68.9	68.0	64.0	72.0	67.6
Mart 2018	69.2	68.4	64.3	72.2	67.9
April 2018	68.4	67.9	63.8	71.7	67.2
Maj 2018	68.2	67.9	64.0	71.7	67.2
Jun 2018	68.5	68.3	64.4	72.1	67.5
Jul 2018	68.0	67.8	63.8	71.6	67.0
Avgust 2018	68.0	67.5	64.1	71.7	67.0
Godišnja vrednost indikatora	68.8	68.2	64.2	72.1	67.6
Standardna devijacija	0.55	0.46	0.31	0.37	0.45
Maksimalna vrednost	69.6	69.2	64.9	72.8	68.4
Minimalna vrednost	68.0	67.5	63.8	71.6	67.0
Granične vrednosti indikatora (zona 5 – zona pored glavnih gradskih saobraćajnih ica)	65	65	55	-	-
Prekoračenje srednje vrednosti	3.8	3.2	9.2	-	-

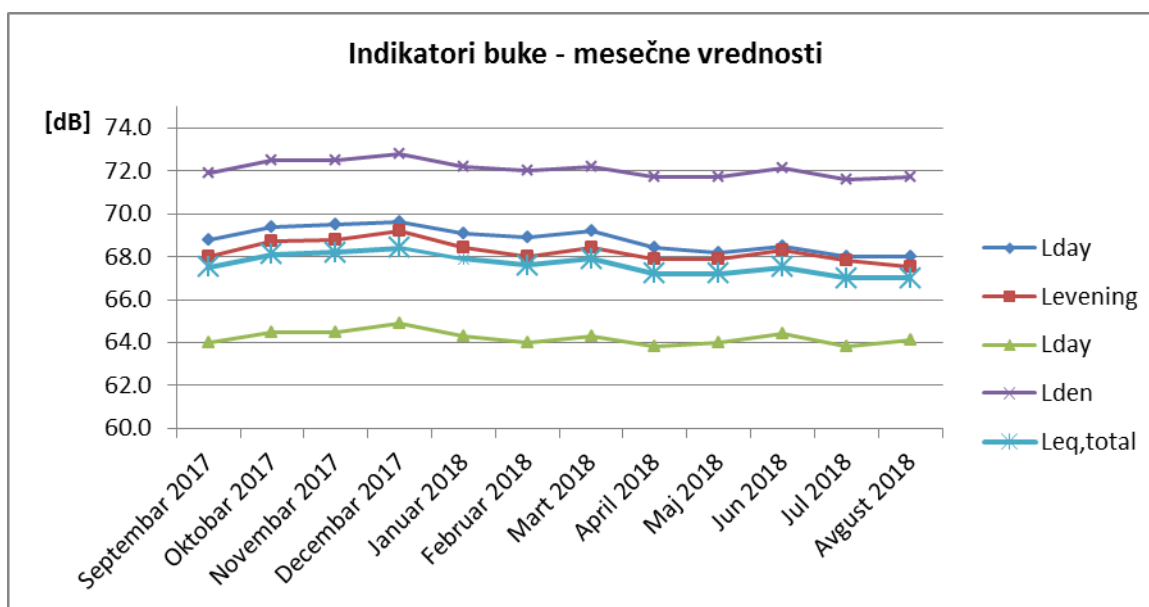

Sl. 2 Promene mesečnih vrednosti indikatora buke u toku 2017/2018 za NMT-2



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije




ATC
01-393
AKREDITOVANA
LABORATORIJA
ZA ISPITIVANJE
SRPS ISO/IEC 17025:2006

3.2 NEDELJNI INDIKATORI BUKE


početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-1				
		L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
04.09.17	11.09.17	63.0	62.6	58.6	66.4	61.9
11.09.17	18.09.17	63.4	63.1	58.7	66.7	62.2
18.09.17	25.09.17	63.3	62.9	58.7	66.6	62.2
25.09.17	02.10.17	63.6	63.4	58.9	66.9	62.5
02.10.17	09.10.17	64.0	64.5	60.2	67.9	63.2
09.10.17	16.10.17	63.6	63.7	59.2	67.1	62.6
16.10.17	23.10.17	63.4	63.1	58.9	66.8	62.3
23.10.17	30.10.17	64.9	64.1	60.3	68.1	63.7
30.10.17	06.11.17	64.0	66.5	59.8	68.3	63.7
06.11.17	13.11.17	63.5	63.1	58.9	66.8	62.4
13.11.17	20.11.17	63.9	63.5	59.5	67.3	62.8
20.11.17	27.11.17	63.6	63.9	59.5	67.3	62.6
27.11.17	04.12.17	64.9	64.9	59.8	68.1	63.8
04.12.17	11.12.17	64.8	64.9	59.4	67.8	63.7
11.12.17	18.12.17	64.1	64.4	59.5	67.6	63.1
18.12.17	25.12.17	64.1	63.6	59.5	67.4	62.9
25.12.17	01.01.18	63.8	64.6	59.7	67.7	63.0
01.01.18	08.01.18	63.1	62.6	60.7	67.7	62.3
08.01.18	15.01.18	63.7	63.5	60.1	67.6	62.7
15.01.18	22.01.18	64.2	63.7	58.9	67.1	63.0
22.01.18	29.01.18	63.9	63.5	59.4	67.2	62.7
05.02.18	12.02.18	63.6	63.4	59.5	67.2	62.5
12.02.18	19.02.18	63.6	64.3	59.8	67.6	62.8
19.02.18	26.02.18	64.2	63.5	59.7	67.5	63.0
26.02.18	05.03.18	65.1	64.6	59.5	67.7	63.6
05.03.18	12.03.18	64.5	63.2	60.2	68.0	63.1
12.03.18	19.03.18	64.5	64.1	60.2	67.6	62.7
19.03.18	26.03.18	64.5	64.5	60.2	67.4	63.0
26.03.18	02.04.18	63.6	64.3	60.4	66.6	63.3
02.04.18	09.04.18	63.1	69.5	59.9	69.5	64.5
09.04.18	16.04.18	62.5	62.8	59.0	66.6	61.7
16.04.18	23.04.18	63.4	63.4	59.3	67.1	62.4
23.04.18	30.04.18	62.8	63.7	59.2	66.9	62.1
30.04.18	07.05.18	62.3	62.9	58.6	66.3	61.5
07.05.18	14.05.18	62.7	62.7	59.3	66.8	61.9
14.05.18	21.05.18	62.8	63.7	59.8	67.3	62.2
21.05.18	28.05.18	63.1	63.4	59.6	67.2	62.3
28.05.18	04.06.18	62.5	63.0	59.6	67.0	61.8
04.06.18	11.06.18	63.3	62.6	59.2	66.8	62.2
11.06.18	18.06.18	62.7	63.6	59.5	67.0	62.0
18.06.18	25.06.18	64.1	68.2	62.6	70.3	64.8
25.06.18	02.07.18	63.8	63.5	59.6	67.3	62.8
02.07.18	09.07.18	62.5	63.4	59.3	66.9	61.8
09.07.18	16.07.18	62.7	62.5	59.0	66.5	61.7
16.07.18	23.07.18	62.8	62.7	58.7	66.5	61.8



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-1				
		L_{day} [dB]	L_{evening} [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{\text{eq, total}}$ [dB]
23.07.18	30.07.18	62.7	62.5	58.2	66.1	61.6
30.07.18	06.08.18	62.3	62.2	58.7	66.2	61.4
06.08.18	13.08.18	62.4	64.7	58.8	66.9	62.1
13.08.18	20.08.18	62.1	62.3	59.1	66.5	61.3
20.08.18	27.08.18	62.5	62.4	58.8	66.4	61.6
27.08.18	03.09.18	62.9	62.5	60.2	67.3	62.1
Srednja vrednost		63.5	63.7	59.5	67.2	62.6
Standardna devijacija		0.76	1.33	0.70	0.76	0.76
Maksimalna vrednost		65.1	69.5	62.6	70.3	64.8
Minimalna vrednost		62.1	62.2	58.2	66.1	61.3
Granične vrednosti indikatora (zona 1 – bolnička zona)		50	50	40	-	-
Prekoračenje srednje vrednosti		13.5	13.7	19.5	-	-

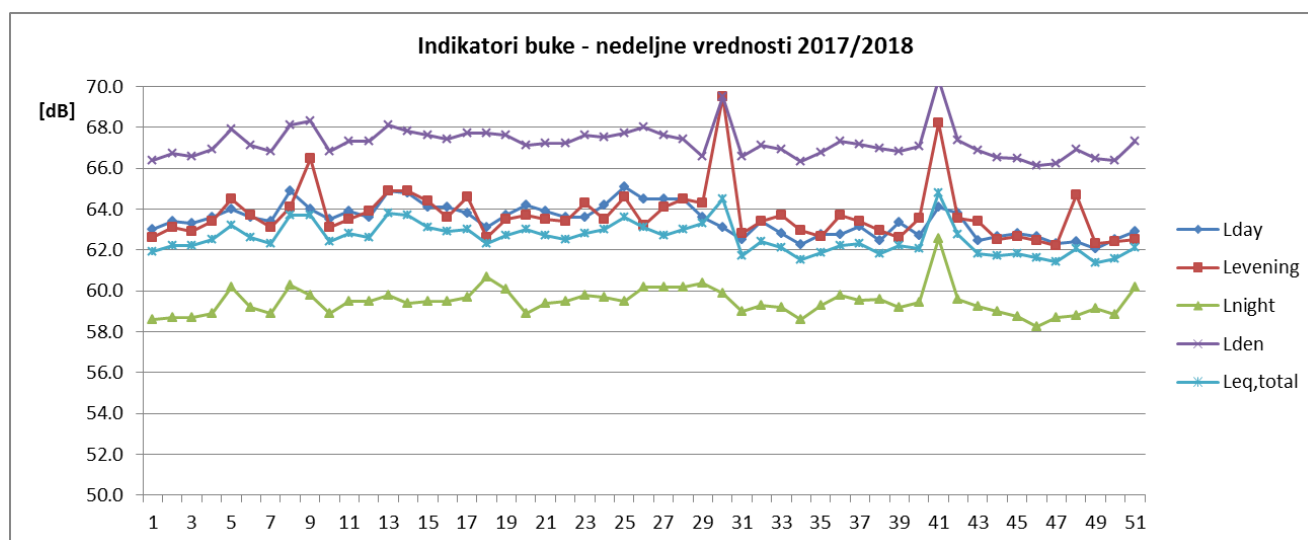

Sl. 3 Promene nedeljnih vrednosti indikatora buke u toku 2017-2018 za NMT-1



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije




početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-2				
		L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
04.09.17	11.09.17	68.6	67.8	63.8	71.7	67.3
11.09.17	18.09.17	68.6	67.8	64.0	71.8	67.4
18.09.17	25.09.17	69.0	68.0	64.0	71.9	67.7
25.09.17	02.10.17	69.2	68.5	64.3	72.3	67.9
02.10.17	09.10.17	69.5	69.0	64.8	72.7	68.3
09.10.17	16.10.17	69.2	68.6	64.4	72.3	68.0
16.10.17	23.10.17	69.0	68.3	64.2	72.1	67.7
23.10.17	30.10.17	69.9	68.9	64.9	72.8	68.6
30.10.17	06.11.17	69.4	68.9	64.3	72.4	68.2
06.11.17	13.11.17	69.2	68.2	64.2	72.1	67.9
13.11.17	20.11.17	69.6	68.8	64.7	72.6	68.3
20.11.17	27.11.17	69.3	68.8	64.7	72.6	68.2
27.11.17	04.12.17	70.3	69.8	65.3	73.4	69.1
04.12.17	11.12.17	69.3	69.2	64.8	72.7	68.2
11.12.17	18.12.17	69.4	68.9	64.3	72.4	68.2
18.12.17	25.12.17	69.7	68.9	65.1	72.9	68.5
25.12.17	01.01.18	69.4	69.1	64.7	72.6	68.3
01.01.18	08.01.18	68.4	67.8	64.7	72.2	67.4
08.01.18	15.01.18	69.1	68.4	64.4	72.3	67.9
15.01.18	22.01.18	69.6	68.7	63.9	72.2	68.2
22.01.18	29.01.18	69.2	68.5	64.2	72.2	68.0
05.02.18	12.02.18	69.1	68.4	64.3	72.2	67.8
12.02.18	19.02.18	69.2	68.9	64.6	72.5	68.1
19.02.18	26.02.18	69.4	68.1	64.4	72.3	68.0
26.02.18	05.03.18	69.3	68.7	64.9	72.7	68.2
05.03.18	12.03.18	69.0	68.2	64.1	72.0	67.7
12.03.18	19.03.18	69.0	68.2	64.2	72.1	67.8
19.03.18	26.03.18	69.7	68.6	64.5	72.5	68.4
26.03.18	02.04.18	69.0	68.2	64.0	72.0	67.7
02.04.18	09.04.18	68.4	67.9	64.1	71.8	67.3
09.04.18	16.04.18	68.2	67.6	63.5	71.4	67.0
16.04.18	23.04.18	68.6	68.0	63.8	71.7	67.4
23.04.18	30.04.18	68.2	67.9	63.8	71.6	67.1
30.04.18	07.05.18	67.8	67.8	63.3	71.2	66.7
07.05.18	14.05.18	68.2	67.6	63.8	71.6	67.1
14.05.18	21.05.18	68.4	68.2	64.2	72.0	67.3
21.05.18	28.05.18	68.6	68.3	64.4	72.2	67.5
28.05.18	04.06.18	68.2	67.8	64.3	71.9	67.1
04.06.18	11.06.18	68.3	67.8	64.1	71.8	67.2
11.06.18	18.06.18	68.3	68.3	64.2	72.0	67.3
18.06.18	25.06.18	68.5	68.7	64.4	72.2	67.6
25.06.18	02.07.18	69.1	68.4	64.5	72.3	67.9
02.07.18	09.07.18	68.2	68.2	64.2	71.9	67.2
09.07.18	16.07.18	68.0	67.6	63.9	71.6	67.0
16.07.18	23.07.18	68.1	67.9	63.8	71.6	67.0




CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA

Laboratorija za buku i vibracije



početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-2				
		L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
23.07.18	30.07.18	68.0	67.6	63.4	71.3	66.8
30.07.18	06.08.18	67.8	67.2	63.5	71.2	66.7
06.08.18	13.08.18	67.7	67.6	64.1	71.6	66.8
13.08.18	20.08.18	67.8	67.3	63.9	71.5	66.8
20.08.18	27.08.18	68.1	67.6	64.0	71.7	67.0
27.08.18	03.09.18	68.5	67.9	64.9	72.3	67.5
Srednja vrednost		68.8	68.3	64.3	72.1	67.7
Standardna devijacija		0.62	0.54	0.43	0.46	0.56
Maksimalna vrednost		70.3	69.8	65.3	73.4	69.1
Minimalna vrednost		67.7	67.2	63.3	71.2	66.7
Granične vrednosti indikatora (zona 5 – zona pored glavnih gradskih saobraćajnica)		65	65	55	-	-
Prekoračenje srednje vrednosti		3.8	3.3	9.3	-	-

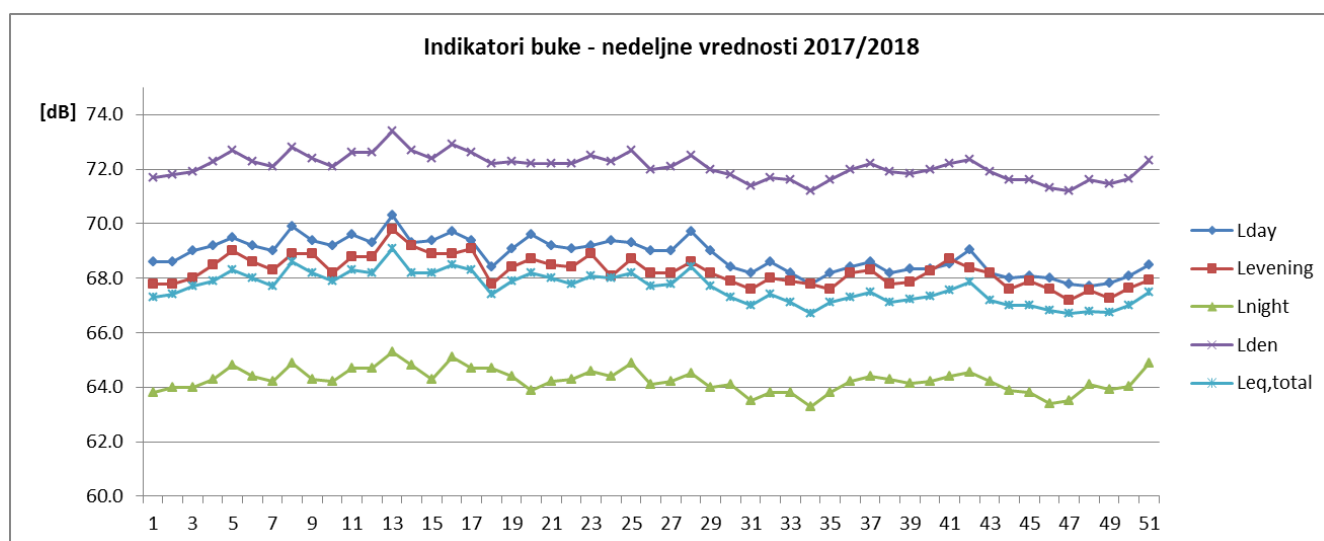

Sl. 4 Promene nedeljnih vrednosti indikatora buke u toku 2017/2018 za NMT-2



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije




ATC
01-393
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2006

3.3 INDIKATORI BUKE ZA PETODNEVNI PERIOD RADNIH DANA


početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-1				
		L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
04.09.17	09.09.17	62.9	62.8	58.4	66.3	61.8
11.09.17	16.09.17	63.5	63.4	58.6	66.7	62.4
18.09.17	23.09.17	63.7	62.9	58.5	66.6	62.4
25.09.17	30.09.17	64.0	63.7	58.7	67.0	62.8
02.10.17	07.10.17	63.7	64.3	58.5	66.9	62.6
09.10.17	14.10.17	63.7	64.0	58.7	67.0	62.6
16.10.17	21.10.17	63.4	63.2	58.5	66.6	62.3
23.10.17	28.10.17	65.5	63.9	60.1	68.1	64.0
30.10.17	04.11.17	64.3	67.4	59.7	68.7	64.1
06.11.17	11.11.17	63.9	63.3	58.5	66.7	62.6
13.11.17	18.11.17	64.3	63.6	59.1	67.2	63.0
20.11.17	25.11.17	63.8	63.6	59.2	67.2	62.7
27.11.17	02.12.17	65.2	65.3	59.4	68.0	64.0
04.12.17	09.12.17	65.4	65.0	58.7	67.7	64.0
11.12.17	16.12.17	63.8	63.9	58.6	66.9	62.7
18.12.17	23.12.17	64.4	63.8	58.8	67.1	63.1
25.12.17	30.12.17	64.0	64.5	59.2	67.4	63.0
01.01.18	06.01.18	63.1	63.0	61.4	68.3	62.6
08.01.18	13.01.18	63.8	63.6	58.8	67.0	62.6
15.01.18	20.01.18	63.7	63.1	58.1	66.4	62.4
22.01.18	27.01.18	64.3	63.7	59.1	67.3	63.0
29.01.18	03.02.18	63.4	63.3	58.6	66.7	62.3
05.02.18	10.02.18	63.7	63.6	59.4	67.3	62.7
12.02.18	17.02.18	64.0	64.5	59.7	67.7	63.1
19.02.18	24.02.18	64.6	64.0	59.9	67.8	63.4
26.02.18	03.03.18	62.2	62.3	56.8	65.1	61.1
05.03.18	10.03.18	64.7	64.1	58.5	66.9	63.1
12.03.18	17.03.18	64.0	64.0	59.0	68.1	62.7
19.03.18	24.03.18	64.1	64.4	59.6	67.6	62.9
26.03.18	31.03.18	63.1	62.6	56.3	64.1	61.7
02.04.18	07.04.18	63.5	70.7	60.0	70.3	65.3
09.04.18	14.04.18	62.7	62.8	59.0	66.6	61.8
16.04.18	21.04.18	63.7	63.6	58.8	66.9	62.6
23.04.18	28.04.18	63.1	63.0	58.7	66.6	62.1
30.04.18	05.05.18	62.3	63.2	58.3	66.2	61.6
07.05.18	12.05.18	62.9	62.9	59.0	66.6	61.9
14.05.18	19.05.18	63.1	63.9	59.7	67.4	62.4
21.05.18	26.05.18	63.3	63.6	59.5	67.2	62.4
28.05.18	02.06.18	62.8	63.2	59.6	67.1	62.1
04.06.18	09.06.18	63.9	62.7	58.9	66.8	62.5
11.06.18	16.06.18	62.8	63.6	59.4	67.0	62.1
18.06.18	23.06.18	64.7	69.3	63.4	71.2	65.6
25.06.18	30.06.18	64.3	63.9	59.3	67.4	63.1
02.07.18	07.07.18	62.6	63.9	59.0	66.8	62.0
09.07.18	14.07.18	63.0	62.7	58.8	66.5	62.0
16.07.18	21.07.18	63.3	62.9	58.6	66.6	62.2
23.07.18	28.07.18	63.2	62.7	58.1	66.2	61.9



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-1				
		L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
30.07.18	04.08.18	62.7	62.4	58.5	66.2	61.7
06.08.18	11.08.18	62.9	65.4	58.5	67.1	62.5
13.08.18	18.08.18	62.4	62.5	59.1	66.5	61.6
20.08.18	25.08.18	62.9	62.6	58.6	66.4	61.8
27.08.18	01.09.18	63.4	62.7	59.9	67.3	62.4
30.07.18	04.08.18	62.7	62.4	58.5	66.2	61.7
Srednja vrednost		63.6	63.8	59.0	67.1	62.6
Standardna devijacija		0.75	1.52	0.98	1.04	0.85
Maksimalna vrednost		65.5	70.7	63.4	71.2	65.6
Minimalna vrednost		62.2	62.3	56.3	64.1	61.1
Granične vrednosti indikatora (zona 1 – bolnička zona)		50	50	40	-	-
Prekoračenje srednje vrednosti		13.6	13.8	19.0	-	-

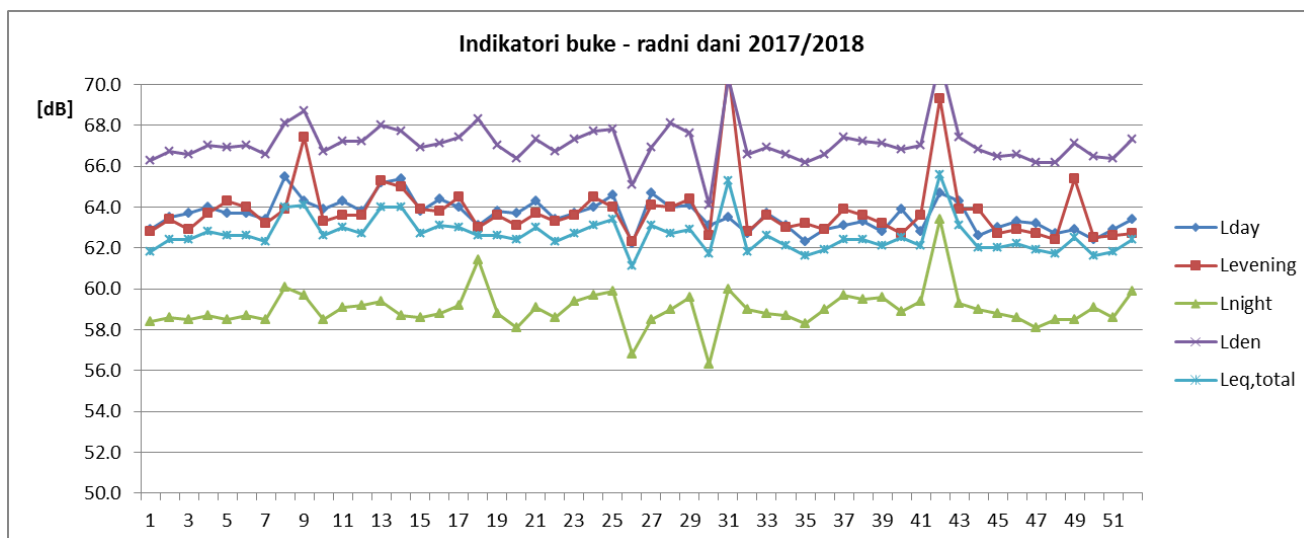

Sl. 5 Promene petodnevni (radni dani) vrednosti indikatora buke u toku 2017/2018 za NMT-1



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije




ATC
01-393
AKREDITOVANA
LABORATORIJA
ZA ISPITIVANJE
SRPS ISO/IEC 17025:2006

početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-2				
		L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
04.09.17	09.09.17	68.7	67.9	63.6	71.7	67.4
11.09.17	16.09.17	68.8	68.0	63.8	71.8	67.5
18.09.17	23.09.17	69.2	68.1	63.7	71.9	67.8
25.09.17	30.09.17	69.3	68.6	64.2	72.3	68.0
02.10.17	07.10.17	69.2	68.5	64.1	72.2	67.9
09.10.17	14.10.17	69.4	68.6	64.3	72.3	68.1
16.10.17	21.10.17	69.1	68.3	64.0	72.0	67.8
23.10.17	28.10.17	70.3	68.7	64.8	72.9	68.8
30.10.17	04.11.17	69.6	69.1	64.1	72.4	68.3
06.11.17	11.11.17	69.4	68.3	64.0	72.1	68.0
13.11.17	18.11.17	69.8	68.8	64.5	72.6	68.4
20.11.17	25.11.17	69.5	68.7	64.8	72.6	68.3
27.11.17	02.12.17	70.5	69.9	65.0	73.3	69.2
04.12.17	09.12.17	69.6	68.8	64.4	72.5	68.3
11.12.17	16.12.17	69.3	68.6	63.9	72.1	67.9
18.12.17	23.12.17	70.0	69.1	64.8	72.9	68.7
25.12.17	30.12.17	69.5	69.2	64.5	72.6	68.3
01.01.18	06.01.18	68.5	68.2	65.4	72.7	67.6
08.01.18	13.01.18	69.3	68.3	64.1	72.1	67.9
15.01.18	20.01.18	69.3	68.2	63.3	71.7	67.8
22.01.18	27.01.18	69.5	68.6	64.1	72.3	68.1
29.01.18	03.02.18	69.0	68.2	63.8	71.9	67.7
05.02.18	10.02.18	69.2	68.5	64.3	72.3	67.9
12.02.18	17.02.18	69.5	68.9	64.5	72.5	68.2
19.02.18	24.02.18	69.6	68.8	64.6	72.6	68.3
26.02.18	03.03.18	68.2	66.4	61.5	70.1	66.6
05.03.18	10.03.18	69.4	68.6	64.2	72.3	68.1
12.03.18	17.03.18	69.2	68.5	64.2	72.2	67.9
19.03.18	24.03.18	70.1	68.6	64.3	72.5	68.6
26.03.18	31.03.18	69.1	68.4	64.0	72.1	67.8
02.04.18	07.04.18	68.7	68.1	64.3	72.0	67.5
09.04.18	14.04.18	68.3	67.7	63.3	71.3	67.1
16.04.18	21.04.18	68.8	68.1	63.5	71.7	67.5
23.04.18	28.04.18	68.3	67.8	63.5	71.5	67.1
30.04.18	05.05.18	67.8	68.0	63.1	71.2	66.8
07.05.18	12.05.18	68.4	67.7	63.7	71.6	67.2
14.05.18	19.05.18	68.6	68.4	64.1	72.0	67.5
21.05.18	26.05.18	68.7	68.5	64.5	72.2	67.7
28.05.18	02.06.18	68.4	67.7	64.1	71.8	67.2
04.06.18	09.06.18	68.6	67.9	63.9	71.7	67.4
11.06.18	16.06.18	68.4	68.2	64.0	71.9	67.3
18.06.18	23.06.18	68.7	69.0	64.2	72.2	67.7
25.06.18	30.06.18	69.4	68.6	64.4	72.4	68.1
02.07.18	07.07.18	68.3	68.4	64.1	71.9	67.3
09.07.18	14.07.18	68.3	67.8	63.8	71.6	67.2
16.07.18	21.07.18	68.4	67.9	63.6	71.6	67.2
23.07.18	28.07.18	68.2	67.8	63.2	71.3	67.0




CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA

Laboratorija za buku i vibracije




početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-1				
		L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
30.07.18	04.08.18	68.0	67.4	63.3	71.2	66.8
06.08.18	11.08.18	67.9	67.7	63.8	71.5	66.9
13.08.18	18.08.18	67.9	67.3	63.8	71.4	66.8
20.08.18	25.08.18	68.3	67.8	63.9	71.7	67.2
27.08.18	01.09.18	68.8	68.0	65.0	72.4	67.7
30.07.18	04.08.18	68.0	67.4	63.3	71.2	66.8
Srednja vrednost		69.0	68.3	64.0	72.0	67.7
Standardna devijacija		0.64	0.56	0.60	0.53	0.56
Maksimalna vrednost		70.5	69.9	65.4	73.3	69.2
Minimalna vrednost		67.8	66.4	61.5	70.1	66.6
Granične vrednosti indikatora (zona 5 – zona pored glavnih gradskih saobraćajnica)		65	65	55	-	-
Prekoračenje srednje vrednosti		4.0	3.3	9.0	-	-

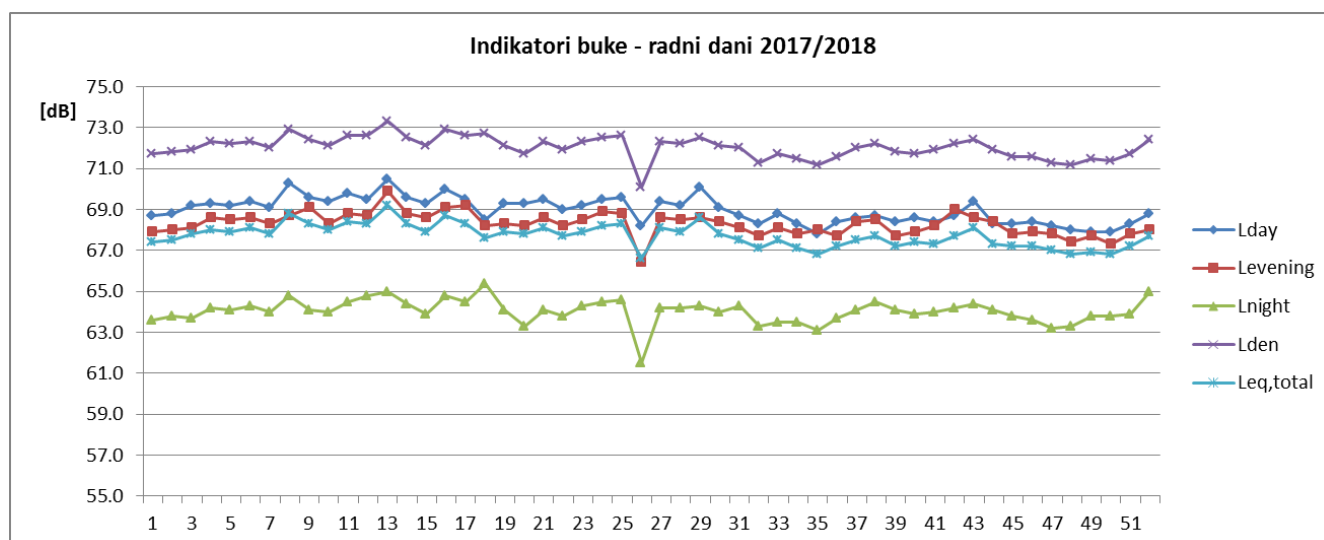

Sl. 6 Promene petodnevni (radni dani) vrednosti indikatora buke u toku 2017/2018 za NMT-2



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije




ATC
01-393
AKREDITOVANA
LABORATORIJA
ZA ISPITIVANJE
SRPS ISO/IEC 17025:2006

3.4 INDIKATORI BUKE ZA VIKENDE


početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-1				
		L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
02.09.17	04.09.17	61.8	62.0	59.2	66.4	61.1
09.09.17	11.09.17	63.1	62.3	59.1	66.6	62.0
16.09.17	18.09.17	62.9	62.0	59.2	66.6	61.8
23.09.17	25.09.17	62.3	62.8	59.2	66.6	61.6
07.10.17	09.10.17	64.9	65.1	62.7	69.8	64.3
14.10.17	16.10.17	63.4	62.9	60.2	67.5	62.5
21.10.17	23.10.17	63.4	62.9	59.8	67.2	62.4
28.10.17	30.10.17	62.8	64.6	60.7	68.1	62.6
04.11.17	06.11.17	63.1	63.1	60.1	67.4	62.3
11.11.17	13.11.17	62.4	62.8	59.8	67.1	61.8
18.11.17	20.11.17	62.7	63.5	60.4	67.6	62.2
25.11.17	27.11.17	62.9	64.5	60.0	67.6	62.5
02.12.17	04.12.17	63.7	64.7	61.8	69.0	63.3
09.12.17	11.12.17	62.9	64.9	60.7	68.1	62.7
16.12.17	18.12.17	64.8	65.5	61.2	68.9	64.1
23.12.17	25.12.17	63.1	63.3	60.9	68.0	62.5
30.12.17	01.01.18	63.0	64.8	60.9	68.2	62.8
06.01.18	08.01.18	63.1	61.6	58.3	66.0	61.7
13.01.18	15.01.18	63.2	63.3	62.1	68.8	62.9
20.01.18	22.01.18	65.4	64.9	60.4	68.5	64.2
27.01.18	29.01.18	62.5	63.0	59.9	67.2	61.9
03.02.18	05.02.18	62.3	62.3	60.2	67.2	61.7
10.02.18	12.02.18	63.0	62.7	59.5	67.0	62.1
17.02.18	19.02.18	62.4	64.0	60.2	67.6	62.1
24.02.18	26.02.18	63.1	61.8	59.2	66.6	61.9
03.03.18	05.03.18	62.1	63.1	60.8	67.5	61.8
10.03.18	12.03.18	62.1	61.3	60.3	68.0	61.0
17.03.18	19.03.18	63.7	63.6	58.6	67.0	61.1
24.03.18	26.03.18	62.2	64.5	60.1	67.0	62.5
31.03.18	02.04.18	63.5	61.7	58.6	66.1	61.1
07.04.18	09.04.18	61.7	62.1	59.4	66.6	61.1
14.04.18	16.04.18	61.9	62.8	59.0	66.5	61.3
21.04.18	23.04.18	62.2	63.0	60.3	67.4	61.8
28.04.18	30.04.18	61.9	65.0	60.2	67.7	62.2
05.05.18	07.05.18	62.0	62.2	59.4	66.6	61.4
12.05.18	14.05.18	62.3	62.1	60.0	67.0	61.6
19.05.18	21.05.18	61.8	63.1	60.0	67.1	61.6
26.05.18	28.05.18	62.8	62.9	59.7	67.0	62.0
02.06.18	04.06.18	61.5	62.2	59.5	66.6	61.1
09.06.18	11.06.18	61.7	62.3	59.9	66.9	61.3
16.06.18	18.06.18	62.3	63.5	59.6	67.1	61.9
23.06.18	25.06.18	62.0	62.3	59.5	66.7	61.3
30.06.18	02.07.18	62.4	62.3	60.2	67.2	61.8
07.07.18	09.07.18	62.1	62.0	59.9	66.9	61.5
14.07.18	16.07.18	61.5	62.0	59.4	66.5	61.0
21.07.18	23.07.18	61.2	61.9	58.9	66.1	60.7
28.07.18	30.07.18	61.2	61.7	58.7	65.9	60.6



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-1				
		L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
04.08.18	06.08.18	61.1	61.7	59.1	66.2	60.7
11.08.18	13.08.18	61.0	61.8	59.4	66.4	60.7
18.08.18	20.08.18	61.2	61.9	59.3	66.4	60.8
25.08.18	27.08.18	61.4	61.8	59.4	66.4	60.9
Srednja vrednost		62.5	62.9	59.9	67.2	61.9
Standardna devijacija		0.94	1.11	0.86	0.83	0.86
Maksimalna vrednost		65.4	65.5	62.7	69.8	64.3
Minimalna vrednost		61.0	61.3	58.3	65.9	60.6
Granične vrednosti indikatora (zona 1 – bolnička zona)		50	50	40	-	-
Prekoračenje srednje vrednosti		12.5	12.9	19.9	-	-

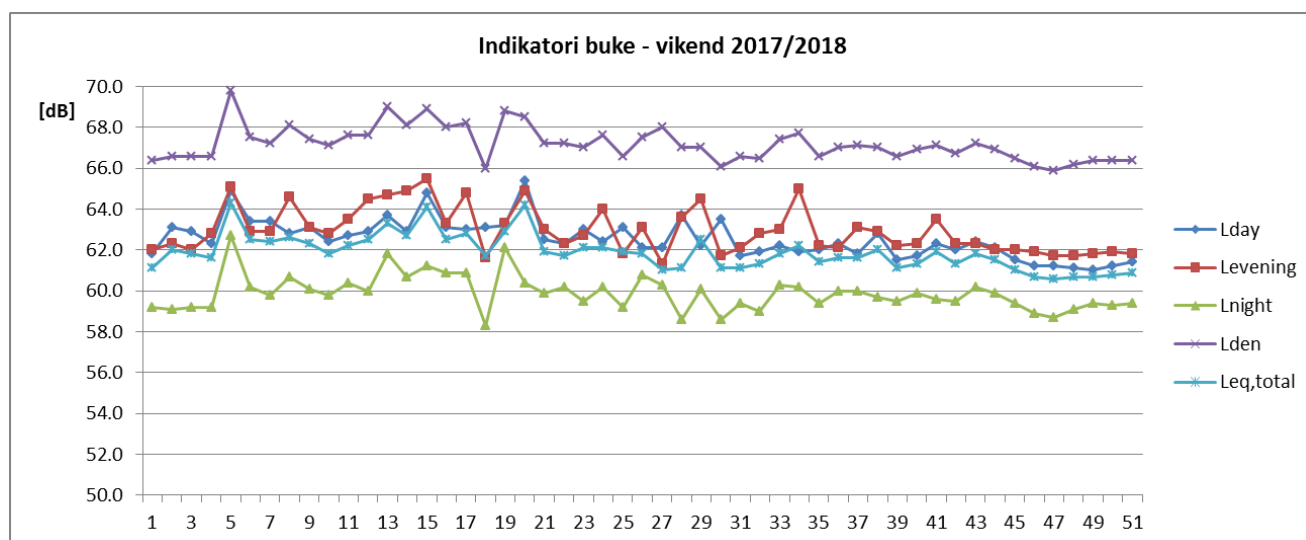

Sl. 7 Promene vikend vrednosti indikatora buke u toku 2017/2018 za NMT-1




CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije




početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-2				
		L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
02.09.17	04.09.17	67.8	67.7	64.0	71.6	66.8
09.09.17	11.09.17	68.3	67.7	64.1	71.8	67.2
16.09.17	18.09.17	68.3	67.3	64.4	71.9	67.2
23.09.17	25.09.17	68.4	67.9	64.5	72.1	67.3
07.10.17	09.10.17	70.1	69.8	66.2	73.8	69.1
14.10.17	16.10.17	68.6	68.5	64.7	72.4	67.6
21.10.17	23.10.17	68.5	68.2	64.7	72.3	67.5
28.10.17	30.10.17	68.8	69.2	65.1	72.8	67.9
04.11.17	06.11.17	69.0	68.4	64.7	72.4	67.8
11.11.17	13.11.17	68.6	68.0	64.6	72.2	67.5
18.11.17	20.11.17	69.0	68.7	65.2	72.8	68.0
25.11.17	27.11.17	68.8	69.1	64.6	72.5	67.8
02.12.17	04.12.17	69.7	69.4	66.0	73.5	68.7
09.12.17	11.12.17	68.4	69.8	65.8	73.3	68.0
16.12.17	18.12.17	69.9	69.7	65.3	73.3	68.8
23.12.17	25.12.17	69.1	68.5	65.7	73.1	68.1
30.12.17	01.01.18	69.1	68.9	65.0	72.7	68.1
06.01.18	08.01.18	68.1	66.8	62.5	70.7	66.6
13.01.18	15.01.18	68.8	68.4	65.2	72.6	67.8
20.01.18	22.01.18	70.1	69.7	65.2	73.2	68.9
27.01.18	29.01.18	68.5	68.1	64.3	72.0	67.4
03.02.18	05.02.18	68.1	67.4	64.3	71.8	67.0
10.02.18	12.02.18	68.8	68.0	64.5	72.2	67.6
17.02.18	19.02.18	68.5	68.8	64.9	72.5	67.7
24.02.18	26.02.18	68.6	65.8	63.8	71.4	67.1
03.03.18	05.03.18	68.8	68.5	65.7	73.0	68.0
10.03.18	12.03.18	67.8	67.1	63.9	71.4	66.7
17.03.18	19.03.18	68.6	67.5	64.2	71.8	67.3
24.03.18	26.03.18	68.6	68.4	65.0	72.5	67.7
31.03.18	02.04.18	68.5	67.6	64.0	71.8	67.3
07.04.18	09.04.18	67.7	67.6	63.6	71.3	66.7
14.04.18	16.04.18	67.8	67.3	64.0	71.5	66.8
21.04.18	23.04.18	67.8	67.6	64.4	71.8	66.9
28.04.18	30.04.18	68.0	68.1	64.3	71.9	67.1
05.05.18	07.05.18	67.5	67.2	63.7	71.3	66.5
12.05.18	14.05.18	67.8	67.5	64.2	71.7	66.8
19.05.18	21.05.18	67.8	67.5	64.5	71.9	66.9
26.05.18	28.05.18	68.2	67.7	64.3	71.9	67.2
02.06.18	04.06.18	67.6	67.8	64.7	72.0	66.9
09.06.18	11.06.18	67.6	67.8	64.8	72.1	66.9
16.06.18	18.06.18	68.1	68.5	64.7	72.2	67.3
23.06.18	25.06.18	68.2	67.9	64.9	72.3	67.3
30.06.18	02.07.18	68.1	67.8	65.0	72.3	67.3
07.07.18	09.07.18	68.0	67.4	64.5	71.9	67.0
14.07.18	16.07.18	67.4	67.2	64.1	71.5	66.5
21.07.18	23.07.18	67.3	67.8	64.1	71.6	66.6
28.07.18	30.07.18	67.3	67.2	63.7	71.2	66.4



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije




početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-1				
		L_{day} [dB]	L_{evening} [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{\text{eq, total}}$ [dB]
04.08.18	06.08.18	67.2	66.9	64.0	71.3	66.3
11.08.18	13.08.18	67.3	67.3	64.7	71.9	66.6
18.08.18	20.08.18	67.5	67.2	64.2	71.6	66.6
25.08.18	27.08.18	67.4	67.1	64.3	71.6	66.6
Srednja vrednost		68.3	68.0	64.6	72.1	67.3
Standardna devijacija		0.71	0.84	0.66	0.65	0.66
Maksimalna vrednost		70.1	69.8	66.2	73.8	69.1
Minimalna vrednost		67.2	65.8	62.5	70.7	66.3
Granične vrednosti indikatora (zona 5 – zona pored glavnih gradskih saobraćajnica)		65	65	55	-	-
Prekoračenje srednje vrednosti		3.3	3.0	9.6	-	-

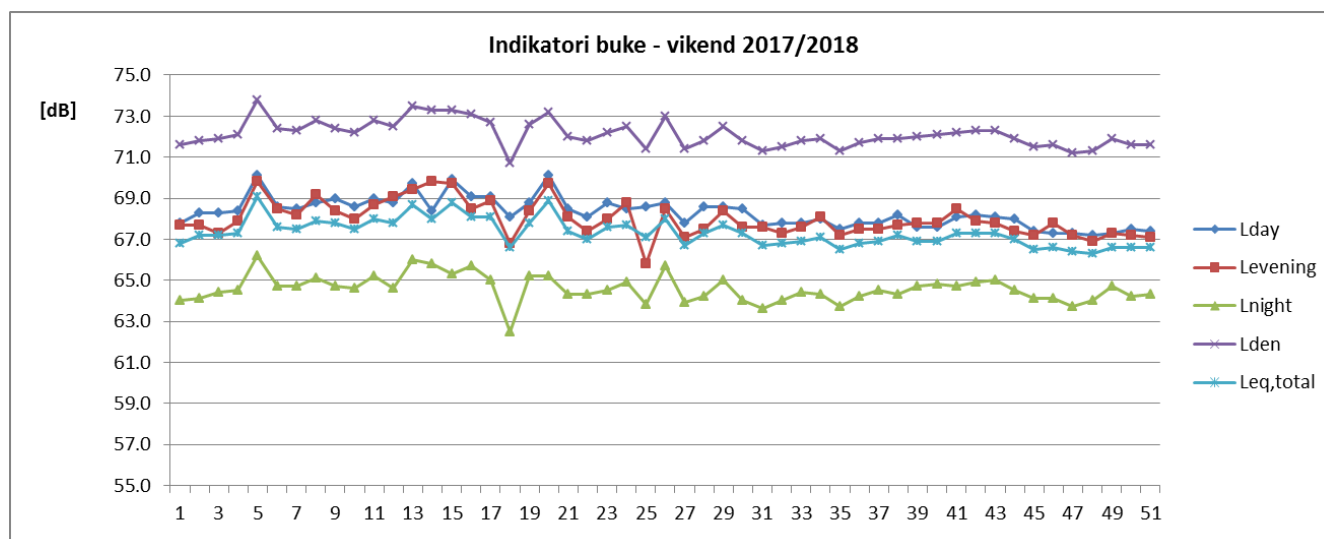

Sl. 8 Promene vikend vrednosti indikatora buke u toku 2017/2018 za NMT-2



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



KONTROLISAO:

Dr Momir Prašćević, red. prof.
Rukovodilac Laboratorije za buku i vibracije

IZVEŠTAJ URADIO:

ODOBRIO:

Dr Darko Mihajlov, docent

M.P.

Dr Tatjana Golubović, vanr. prof.
Rukovodilac Centra za tehnička ispitivanja

- *Kraj izveštaja* -



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

6. PRILOZI

PRILOG 1: PODACI O OVLAŠĆENOJ ORGANIZACIJI

Rešenje o registraciji kod trgovinskog suda

Посл. бр. <u>FI 221/2011</u>	
Privredni	суд у <u>Nišu</u> судија <u>Olivera Jovanović</u>
као судија појединац у судскорегистарској правној ствари предлагача _____	
<u>Univerzitet u Nišu - Fakultet zaštite na radu</u> . <u>Niš</u>	
ради уписа <u>usklađivanje sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti</u>	
дана <u>15.11.2011</u> донео је:	
РЕШЕЊЕ	
Усваја се захтев предлагача за упис у судски регистар и одређује се упис у судски регистар, у регистарски улогач	
бр. <u>1-374</u>	података садржаних у прилозима уз пријаву бр. <u>3</u>
који су саставни део овог решења.	
 Судија <u>Olivera Jovanović</u>	
Privrednom Apelacionom	
Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба, преко овог суда _____	
суду у <u>Београду</u>	у року од 8 дана од дана постављања преписа решења.

4. Препис решења



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

Sertifikat o akreditaciji



Акредитационо тело Србије

Accreditation Body of Serbia

Београд

Belgrade

додељује

awards

01311

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ

Accreditation Certificate

којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености
confirming that Conformity Assessment Body

Универзитет у Нишу
Факултет заштите на раду у Нишу
Центар за техничка испитивања
Ниш

акредитациони број

accreditation number

01-393

задовољава захтеве стандарда

fulfils the requirements of

SRPS ISO/IEC 17025:2006

(ISO/IEC 17025:2005)

те је компетентно за обављање послова испитивања

and is competent to perform testing activities

који су специфицирани у важећем издању Обима акредитације

as specified in the valid Scope of Accreditation

Важеће издање Обима акредитације доступно је на интернет адреси: www.ats.rs

Valid Scope of Accreditation can be found at: www.ats.rs

Акредитација додељена
Date of issue

21.05.2017.

Акредитација важи до
Date of expiry

20.05.2021.



Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног споразума о признавању еквивалентности система акредитације Европске организације за акредитацију (EA MLA) и ILAC MRA споразума у овој области. / ATS is a signatory of the EA MLA and ILAC MRA in this field.



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA Laboratorija za buku i vibracije

Rešenje o ovlašćivanju za merenje buke u životnoj sredini



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-01-01419/2017-16

Датум: 11.07.2017. године.

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 25. Закона о заштити од буке у животnoj средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 5а. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др.закон и 62/17) и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/16), а по захтеву Факултета заштите на раду, Центар за техничка испитивања, Чарнојевића 10а, Ниш, Министарство заштите животне средине, доноси:

РЕШЕЊЕ

1. **УТВРЂУЈЕ СЕ** да Факултет заштите на раду, Центар за техничка испитивања, Чарнојевића 10а, Ниш, **испуњава прописане услове да врши мерење буке у животnoj средини.**

2. **ОВЛАШЋУЈУ СЕ:**

1. др Драган Цветковић, дипл.инж.зр.;
2. др Момир Прашчевић, дипл.инж.ел.;
3. др Дарко Михајлов, дипл.инж.маш.;
4. др Дејан Васовић, дипл.инж.зжс;
5. Младена Лукић, дипл.физ. за примењену физику.

запослени на Факултету заштите на раду, Центар за техничка испитивања, Чарнојевића 10а, Ниш, да врше мерење из тачке 1. диспозитива решења.

3. Ово решење важи четири године.

Образложење

Факултет заштите на раду, Центар за техничка испитивања, Чарнојевића 10а, Ниш, поднео је захтев Министарству пољопривреде и заштите животне средине за овлашћивање организације за мерење буке у животnoj средини.

На основу захтева, приложене документације (Уверење о исправности мерила, документација о лицима за која се тражи овлашћење за мерење буке у животnoj средини, Извештај о мерењу буке у животnoj средини и Сертификат о акредитацији број 01-393) и увида на лицу места (Записник од 10.07.2017. године), утврђено је да Факултет заштите на раду, Центар за техничка испитивања, Чарнојевића 10а, Ниш, испуњава услове да врши мерење буке у животnoj средини, а на основу Правилника о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијење овлашћења за мерење буке ("Службени гласник РС", бр. 72/2010), како је решено у диспозитиву.

У складу са чланом 25. став 5. Закона о заштити од буке у животnoj средини утврђено је да решење важи четири године.

Поука о правном леку:

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања решења.

